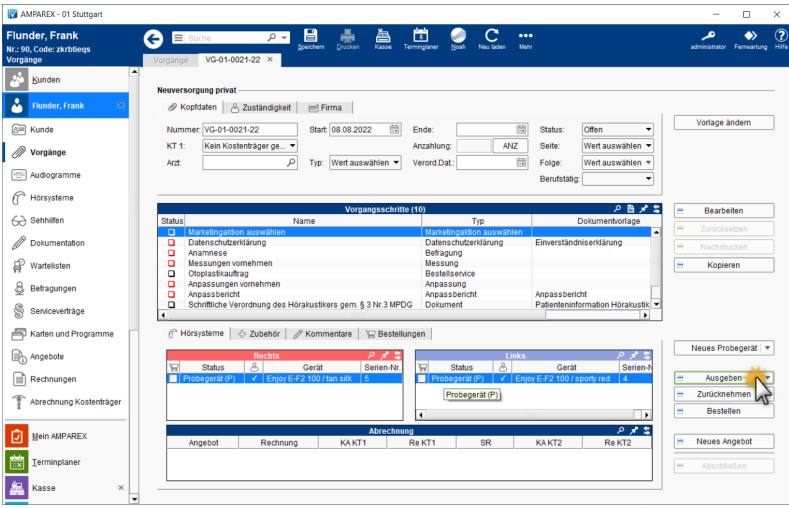
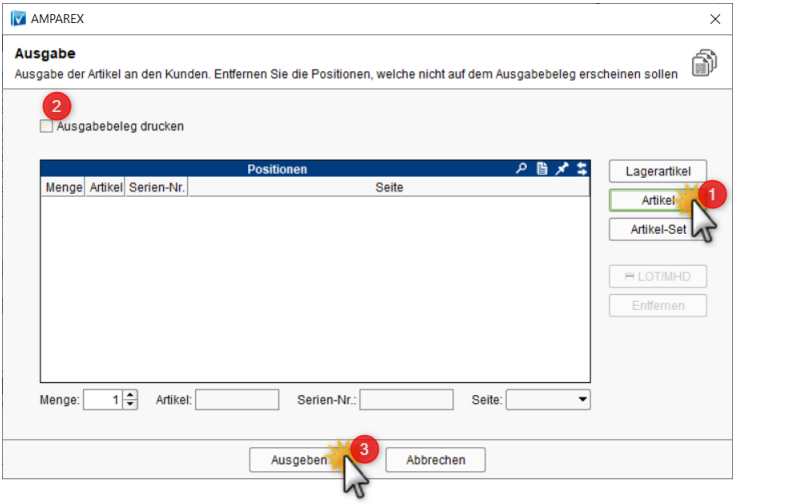


Zubehör Otoplastiken nachträglich zum Probegerät ausgeben | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

Hat man bereits eine Ausgabe (Lieferung) eines Probegerätes gemacht, ist es möglich eine zusätzliche Ausgabe (Lieferung) von Zubehör zu machen, die mit diesem Probegerät verknüpft wird.

Befindet sich der Anwender im 'Vorgang HG Versorgung' und es wurde mindestens ein Probegerät bereits ausgegeben, wird wie folgt vorgegangen:

	Beschreibung
	(a) Im Vorgang selektiert man das gewünschte Probegerät und klickt auf die Schaltfläche 'Ausgabebeleg'. (b) Wenn zwei Probegeräten gleichzeitig Zubehör zugeordnet werden soll dann geht dies nur, wenn beide Probegeräte in einer Ausgabe (Lieferung) zusammen ausgegeben wurden. (c) Wurden die Probegeräte getrennt von einander ausgegeben, so muss auch die zusätzliche Ausgabe von Zubehör zu diesen Geräte in zwei getrennten Ausgaben stattfinden. (d) Im erscheinenden Dialog wählt man die Schaltfläche 'Ausgabe'.
	(e) Es öffnet sich der Dialog 'Ausgabe'. Über diesen fügt man das gewünschte Zubehör ein. Dabei ist es möglich eine Seite für das Zubehör auszuwählen. Dies ist dann relevant wenn sich zwei Hörgeräte in der ursprünglichen Ausgabe (Lieferung) befanden. (f) Das eingefügte Zubehör wird über die Schaltfläche 'Ausgeben' bestätigt. Dabei wird das zusätzliche Zubehör mit den Hörsystemen verknüpft und ausgegeben.

Siehe auch ...

- [Otoplastik bestellen | Arbeitsablauf](#)
- [Otoplastik Rücknahme | Arbeitsablauf](#)
- [Otoplastik zusätzlich verkaufen | Arbeitsablauf](#)
- [Zubehör Otoplastiken nachträglich zum Probegerät ausgeben | Arbeitsablauf](#)