


Übersicht AED | Abrechnung KT

Hinweis

In AMPAREX werden bestimmte Daten nur eine gewisse Zeit aufbewahrt (gespeichert) und nach dieser Zeit gelöscht.

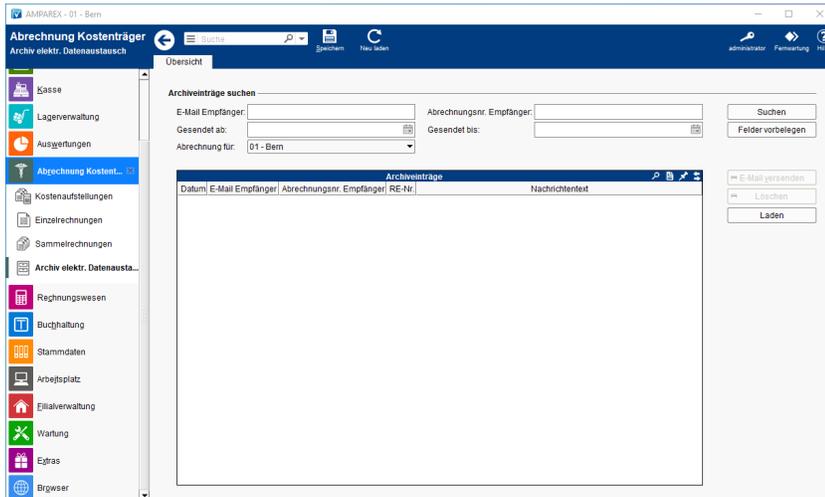

Arbeitsabläufe

- [Erneutes versenden einer elektronischen Abrechnung | Arbeitsablauf, Abrechnung KT](#)

Lösungen

- [Es werden keine Archiveinträge angezeigt](#)

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.


Maskenbeschreibung

Archiveinträge suchen

Schaltfläche	Beschreibung
Suchen	Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle darunter aufgelistet.
Felder vorbelegen	Diese Schaltfläche dient zum Zurücksetzen der Kriterien.

Tabelle 'Archiveinträge'

Übersicht AED | Abrechnung KT

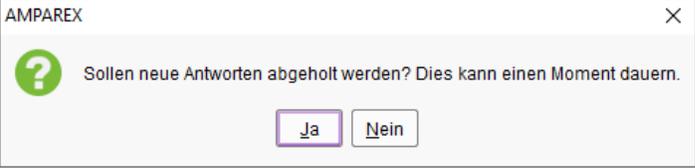Schaltfläche	Beschreibung
= Erneut versenden	Diese Schaltfläche überträgt die markierte E-Mail nochmals an den Empfänger. Änderungen in den enthaltenen Rechnungen werden dabei nicht übernommen.
= Löschen	Diese Schaltfläche löscht den markierten Eintrag ausschließlich aus dem Archiv. Rechnungsdaten werden hierbei nicht gelöscht.
Laden	Schweiz/CH: Herunterladen von Antworten aus dem 'MediData-Netzwerk'. Die Antworten können in der Maske 'Einzelrechnung' eingesehen werden.  <p>The screenshot shows a dialog box titled 'AMPAREX' with a close button (X) in the top right corner. On the left is a green question mark icon. The text reads: 'Sollen neue Antworten abgeholt werden? Dies kann einen Moment dauern.' Below the text are two buttons: 'Ja' and 'Nein'.</p>