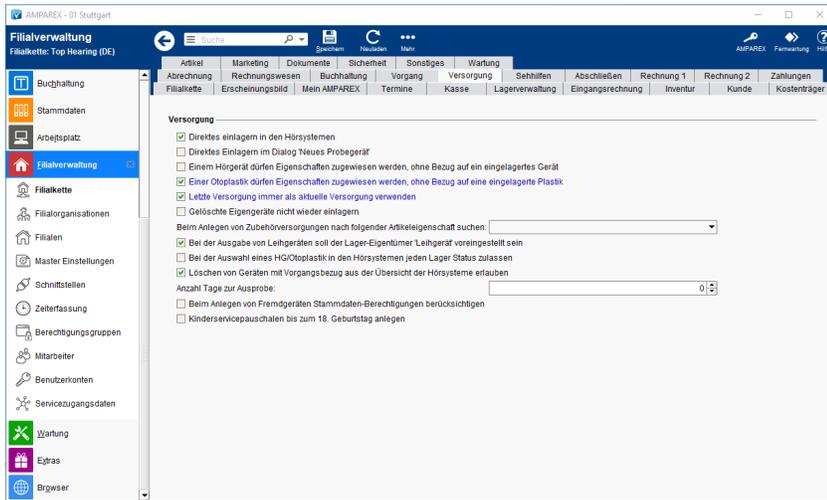


Versorgung | Filialverwaltung



Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt. <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Tip</p> <p>Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen 'Änderungsprotokoll Protokolltyp 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.</p> </div>

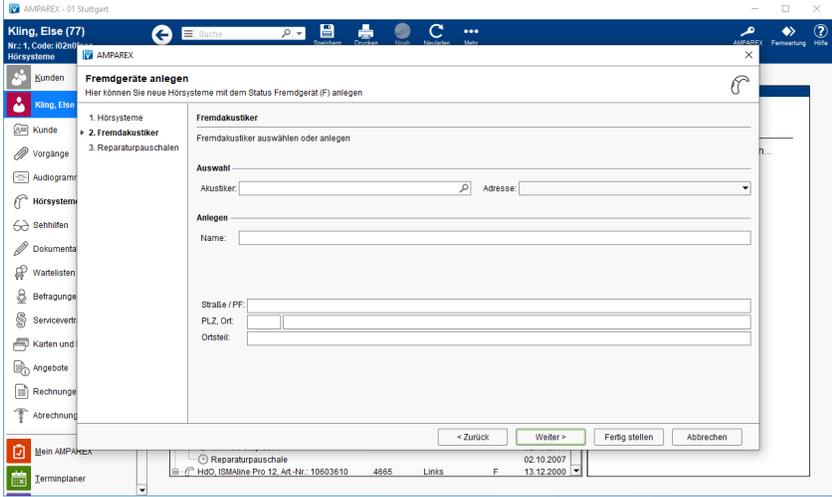
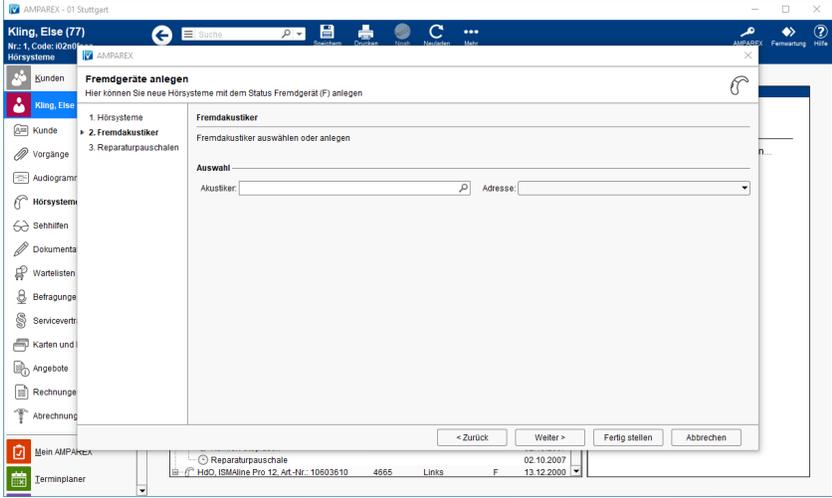
Maskenbeschreibung

Versorgung

Standard	Feld	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	Direktes Einlagern in den Hörsystemen	Möglichkeit in den Hörsystemen des Kunden Geräte direkt einzulagern.
<input type="checkbox"/>	Direktes Einlagern im Dialog 'Neues Probergerät'	Möglichkeit im Vorgang in der Probergeräteausgabe (Probergerätewizard) ein Gerät einzulagern. Voraussetzung ist, dass der Name der Hörgeräte im Artikelkatalog und in Noah zu 100 % übereinstimmen.
<input type="checkbox"/>	Einem Hörgerät dürfen Eigenschaften zugewiesen werden, ohne Bezug auf ein eingelagertes Gerät	In den Hörsystemen des Kunden besteht die Möglichkeit, weitere Angaben (Eigenschaften) zum Hörgerät zu hinterlegen. Die Option ermöglicht diese Funktion auch dann, wenn zum Hörsystem noch keine Seriennummer hinterlegt wurde, also noch kein Lagerbezug hergestellt wurde.

Versorgung | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	Auch mengenverwalteten Otoplastiken und Hörern dürfen Eigenschaften zugewiesen werden	In den Hörsystemen des Kunden besteht die Möglichkeit, weitere Angaben (Eigenschaften) zur Otoplastik zu hinterlegen. Die Option ermöglicht diese Funktion auch dann, wenn zur Otoplastik noch keine Seriennummer hinterlegt wurde, also noch kein Lagerbezug hergestellt wurde oder Otoplastiken generell nicht nach Seriennummern verwaltet werden.						
<input type="checkbox"/>	Letzte Versorgung immer als aktuelle Versorgung verwenden	Ohne diese Option wird immer das letzte Eigengerät als aktuelle Versorgung in der Kundenmaske angezeigt.						
<input type="checkbox"/>	Gelöschte Eigengeräte nicht wieder einlagern							
	Beim Anlegen von Zubehörversorgung nach folgender Articleigenschaft suchen							
<input checked="" type="checkbox"/>	Bei der Ausgabe von Leihgeräten soll der Lager-Eigentümer 'Leihgerät' voreingestellt sein	Soll dem Kunden ein Leihgerät über einen Reparaturvorgang ausgegeben werden, müssen Leihgeräte im Lager mit dem Eigentümer: Leihgerät geführt werden. Bei der Auswahl werden diese Leihgeräte zur Ausgabe vorgeschlagen.						
<input type="checkbox"/>	Bei der Auswahl eines Gerätes /Otoplastik in den Hörsystemen alle Lager-Status zulassen							
<input checked="" type="checkbox"/>	Löschen von Geräten mit Vorgangsbezug aus der Übersicht der Hörsysteme erlauben	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Die Versorgung bzw. das Zubehör kann in der Übersicht der Hörsysteme bzw. vom Zubehör des Kunden gelöscht werden, auch wenn ein Vorgangsbezug besteht. Dies kann nur ein Administrator,</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Die Versorgung bzw. das Zubehör kann in der Übersicht der Hörsysteme bzw. vom Zubehör des Kunden nicht gelöscht werden, wenn ein Vorgangsbezug besteht.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Ausnahme</p> <p><i>Ausnahme:</i> Mit der Berechtigungsgruppe 'Administration', wenn es sich um eine Reservierung, um ein Fremdgerät handelt oder wenn das Hörsystem gerade neu angelegt und noch nicht gespeichert wurde, ist dies dennoch möglich.</p> </div>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Versorgung bzw. das Zubehör kann in der Übersicht der Hörsysteme bzw. vom Zubehör des Kunden gelöscht werden, auch wenn ein Vorgangsbezug besteht. Dies kann nur ein Administrator,	<input type="checkbox"/>	Die Versorgung bzw. das Zubehör kann in der Übersicht der Hörsysteme bzw. vom Zubehör des Kunden nicht gelöscht werden, wenn ein Vorgangsbezug besteht.
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Versorgung bzw. das Zubehör kann in der Übersicht der Hörsysteme bzw. vom Zubehör des Kunden gelöscht werden, auch wenn ein Vorgangsbezug besteht. Dies kann nur ein Administrator,							
<input type="checkbox"/>	Die Versorgung bzw. das Zubehör kann in der Übersicht der Hörsysteme bzw. vom Zubehör des Kunden nicht gelöscht werden, wenn ein Vorgangsbezug besteht.							
0	Anzahl der Tage zur Ausprobe	Vorbelegung, ab wie vielen Tagen ein Hinweis in den 'Erinnerungen' unter 'Mein AMPAREX' erscheint.						

		Beschreibung
<input type="checkbox"/>	Beim Anlegen von Fremdgeräten Stammdaten-Berechtigungen berücksichtigen	<input type="checkbox"/> <p>Wird ein Fremdgerät beim Kunden über Hörsysteme Funktionsleiste Mehr-Menü angelegt, können Fremdakustiker während der Anlage des Fremdgerätes, im Schritt 2 des Wizards, angelegt werden.</p> 
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> <p>Hat ein Benutzer kein Recht einen Kostenträger (Stammdaten Kostenträger) zu bearbeiten (speichern) oder anzulegen, kann während der Anlage eines Fremdgerätes nur ein Fremdakustiker ausgewählt, aber nicht angelegt werden.</p> 
<input type="checkbox"/>	Kinderservicepausen bis zum 18. Geburtstag anlegen	