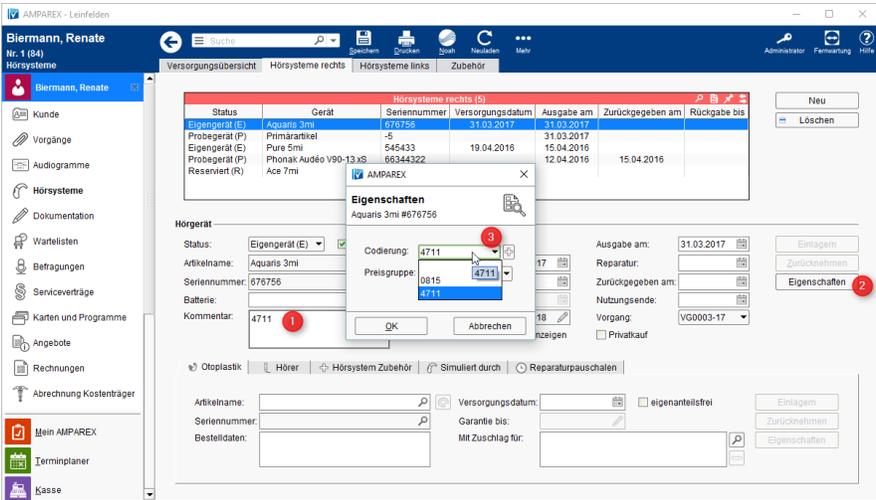
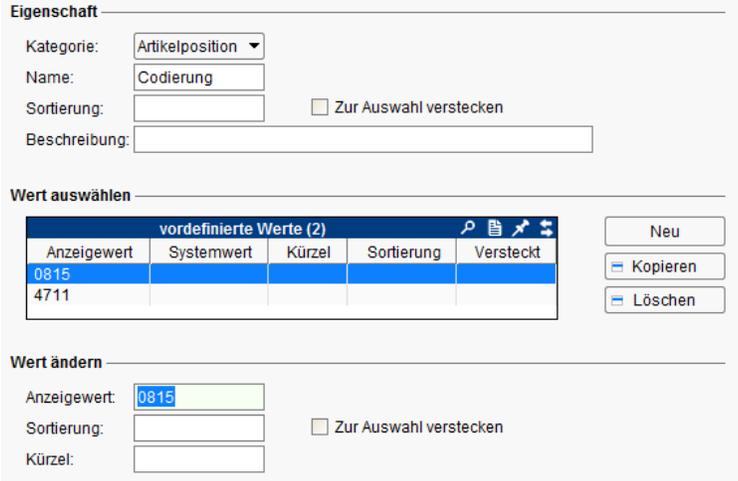


Codierte Hörsysteme | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

Hersteller produzieren Hörgeräte speziell für große Firmen oder Einkaufsgemeinschaften. Diese werden codiert und nur für diese Firmen oder Einkaufsgemeinschaften in Noah freigeschaltet. Wenn jetzt ein Kunde zu einem 'freien' Akustiker wechselt, kann dieser den Code zwar bekommen, muss diesen aber händisch jedes Mal neu, auf jedem Noah Arbeitsplatz eintragen.

Screenshot der AMPAREX Software	Beschreibung
 <p>The screenshot shows the AMPAREX software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Versorgungsübersicht', 'Hörsysteme rechts', 'Hörsysteme links', and 'Zubehör'. Below this is a table of hearing systems. A pop-up window titled 'Eigenschaften' is open, showing details for 'Aquaris 3mi #676756'. The 'Codierung' field in this pop-up is highlighted with a red circle (2). In the main table, the 'Kommentar' field for the first entry is highlighted with a red circle (1).</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Hinweis</p> <p>Diese Codierung wird in einer speziellen Datenbank gespeichert, auf welche AMPAREX leider keinen Zugriff hat.</p> <p>Um diese Codierung nicht jedes Mal erneut eingeben zu müssen, tragen Sie die Nummer als Kommentar (1) am Hörgerät ein, sodass diese später gefunden werden kann. Alternativ kann diese als Eigenschaft (2) am Hörgerät hinterlegt werden.</p>
 <p>The screenshot shows the 'Eigenschaft' configuration window. It has a 'Kategorie' dropdown set to 'Artikelposition' and a 'Name' field set to 'Codierung'. Below this is a table of 'vordefinierte Werte (2)'. The first row has 'Anzeigewert' 0815 and 'Systemwert' 4711. The 'Wert auswählen' section shows the 'Anzeigewert' field with 0815 selected. There are buttons for 'Neu', 'Kopieren', and 'Löschen'.</p>	<p>Da die Nummer gleich ist, können diese als Artikelpositionseigenschaft in den Stammdaten angelegt und ergänzt werden (Stammdaten Eigenschaften Neu anlegen).</p>

Siehe auch ...

- Ausgabe von konfigurierbaren Hörsystemen z. B. sDemo, Tune oder Tune T | Arbeitsablauf
- Codierte Hörsysteme | Arbeitsablauf
- Cros bzw. Bicrosgeräte | Arbeitsablauf
- Ein in Noah angepasstes Hörgerät suchen | Arbeitsablauf
- Hörgeräteabbruch | Arbeitsablauf Vorgangsweise bei einem Abbruch einer Hörgeräteversorgung
- Hörgeräteverlust während der Anpassphase | Arbeitsablauf
- Probegeräte und reservierte Geräte ausgeben | Arbeitsablauf
- Wie werden Tinnitusgeräte eingerichtet und abgerechnet | Arbeitsablauf