


Verordnung | Otoplastik, AKUSTIK

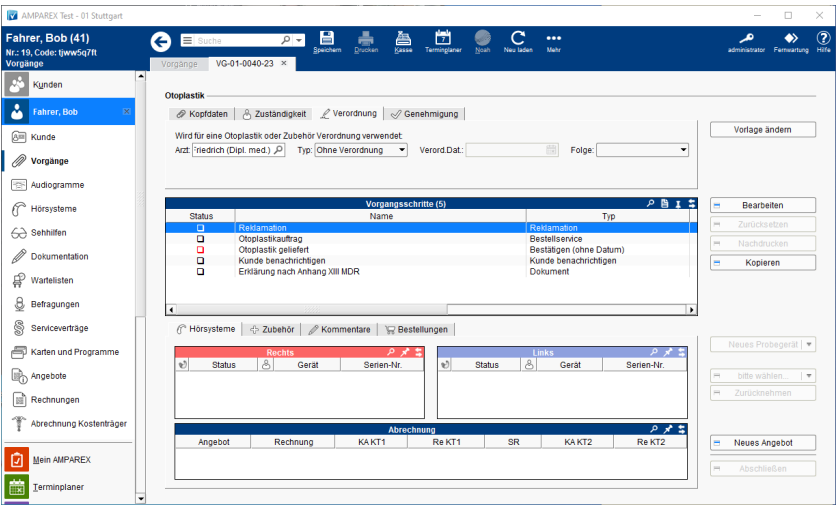

Maskenbeschreibung

Die nachfolgenden Daten werden für eine Otoplastik- oder Zubehör-Verordnung verwendet:

Feld	Beschreibung
Arzt	Auswahl eines Arztes aus den Stammdaten.
Typ	Wählen Sie, ob eine binaurale, monaurale oder keine Verordnung vorliegt.
Vord.Dat.	Gibt es eine Verordnung, tragen Sie das Verordnungsdatum ein.